


Копирование на компьютер Mac

Копируйте файлы на компьютер Mac следующим способом.

1 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.

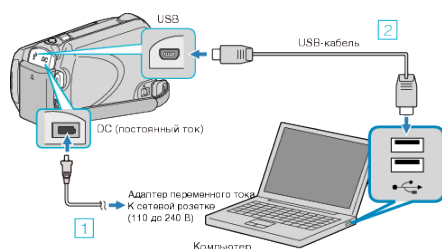


1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

2 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.


- Для этого процесса не требуется прилагающееся программное обеспечение.

2 Откройте ЖК-монитор.

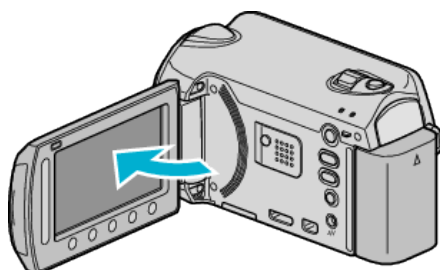

- Появится МЕНЮ USB.

3 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПК“ и нажмите $\odot$.

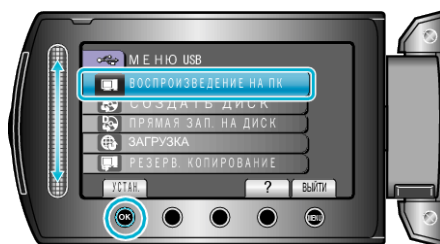


- Все последующие операции выполняются на ПК.

4 Щелкните на "EVERIO_MEM" или на иконку "EVERIO_SD" на рабочем столе.

- Папка откроется.

5 Щелкните значок отображения столбцов.


Значок отображения столбцов

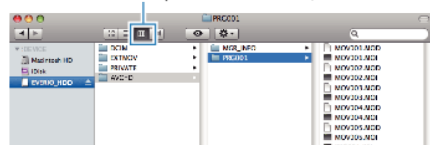

- Найдите папку с необходимыми файлами.

6 Скопируйте файлы в любую папку на компьютере (на рабочий стол, и т.п.).

Файлы для копирования

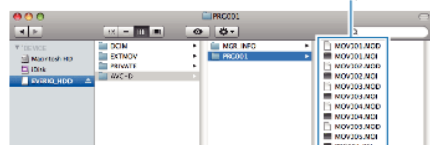

Чтобы использовать файлы MTS с iMovie, импортируйте файлы с помощью iMovie.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Для редактирования файлов используйте программное обеспечение, поддерживающее файлы формата MTS/JPEG.
- При отключении аппарата от компьютера, перетащите и опустите значок "EVERIO_MEM" или "EVERIO_SD" с рабочего стола в мусорную корзину.

iMovie и iPhoto

Вы можете импортировать файлы с аппарата на компьютер Apple с помощью iMovie '08, '09, '11 (для видео) или iPhoto (для фото). Чтобы проверить соответствие системным требованиям, выберите "Об этом компьютере" из меню Apple. Вы сможете определить версию операционной системы и получить информацию о процессоре и памяти.

- Новейшую справочную информацию об iMovie или iPhoto можно получить на веб-сайте Apple.
- Для получения информации о том, как пользоваться iMovie или iPhoto, обратитесь к файлу справки соответствующей программы.
- Не гарантируется, что функции будут работать с любым компьютером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Когда папки и файлы удаляются/перемещаются/переименовываются на ПК, они больше не могут быть воспроизведены на этой аппарате.
- Файлы MTS, скопированные на компьютер Mac, не могут быть импортированы в iMovie.